

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI N.1 LETTO ELETTRICO PER TERAPIA INTENSIVA UTIC DEL P.O. CASALE MONFERRATO – R.D.O. N. 3050107

La Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indicata in oggetto e nominata con determinazione del Direttore della S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 1132 del 02.08.2022, esecutiva nelle forme di legge, ha svolto a distanza la propria attività tramite i seguenti componenti:

Presidente

Dott. Giuseppe Tortolina – S.C. Cardiologia A.S.L. AL - Dirigente
(Designato con nota prot. n. 100907 del 18.07.2022)

Componenti

Ing. Andrea Orsi – S.C. Tecnologie Biomediche ICT
(Designato con nota prot. n. 104133 del 27.07.2022)

Ing. Massimo Giacobbe – S.C. Tecnologie Biomediche ICT
(Designato con nota prot. n. 104133 del 27.07.2022)

Si precisa che la Commissione Giudicatrice ha deciso di avvalersi della facoltà prescritta dall'art. 77 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente la possibilità di lavorare a distanza, anche in relazione alla circostanza che la procedura negoziata in esame è stata avviata e processata mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

I componenti la Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 1132 del 02.08.2022, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50.

La Commissione Giudicatrice prende atto preliminarmente del fatto che è stata processata in data 27.06.2022, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la R.D.O. n. 3050107 aperta a tutti gli iscritti alla categoria di riferimento per la fornitura in oggetto.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 15.07.2022 sono pervenute e registrate tramite piattaforma M.E.P.A. le seguenti offerte:

DITTA	SEDE	P.IVA	DATA ED ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
Malvestio S.p.A.	VIA G. MARCONI, 12/D - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)	00197370281	13.07.2022 17:34
Stryker Italia S.r.l.	VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL, 13/15 00148 ROMA	06032681006	11.07.2022 14:49
Hill-Rom	VIA AMBROSOLI, 6 - 20054 RODANO (MI)	08817300158	13.07.2022 15:19

				Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-5	Testiera e pediera Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	T	6	Criterio Tabellare: 6 punti se bilaterale; 0 punti se unilaterale
B-6	Comando manuale CPR lato operatore Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	T	6	Criterio Tabellare: 6 punti se bilaterale; 0 punti se unilaterale
B-7	Movimentazione Trendelemburg e anti Trendelemburg (valutazione dell'intervallo in gradi delle inclinazioni) Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	Q	6	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore di massio intervallo. Alle altre Ditte punteggi inferiori secondo la seguente formula: $P = (Vn*6)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare alla Ditta "n" Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-8	Pannello di controllo primario per l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia cardiologica, tasto unico per la posizione di visita, blocco di tutte o parti delle funzioni in uso al paziente: numero di servizi e funzioni disponibili sul pannello di controllo Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	Q	6	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presenta il valore maggiore di numero di servizi e funzioni. Alle altre Ditte punteggi inferiori secondo la seguente formula: $P = (Vn*6)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare alla Ditta "n" Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-9	Sistema di alimentazione elettrica a rete e tramite batteria tampone ricaricabile e indicatore dello stato di carica della batteria ed autonomia della stessa Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-16	Q	4	Criterio Quantitativo: punteggio maggiore alla Ditta che presenta la durata maggiore dell'autonomia della batteria. Alle altre Ditte punteggi inferiori secondo la seguente formula: $P = (Vn*4)/Vmax$ Dove: P = punteggio da assegnare alla Ditta "n" Vn = valore proposto Vmax = valore max. proposto
B-10	Materasso antidecubito ad uso cardiologico: tipologia e modalità funzionale, facilità di sanificazione ed igienizzazione Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17	D	12	Criterio Discrezionale: 12 punti alla migliore tipologia materssovalutato nell'insieme delle specifiche tecnico-funzionali antibatterico. Agli altri sistemi punteggi inferiori.
B-11	Durata garanzia di tutto il sistema	T	6	Criterio Tabellare: 6 punti per periodo di garanzia > di 36 mesi; 3 punti per periodo di garanzia tra 25 mesi e 36 mesi; 0 punti per periodo di garanzia da 0 a 24 mesi

B-12	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto, descrizione piano di manutenzione preventiva, disponibilità di attrezzatura sostitutiva in caso di tempi di riparazione prolungati	D	6	Criterio Discrezionale: 6 punti al sistema con le migliori caratteristiche tecniche. Agli altri sistemi punteggi inferiori
	TOTALE		70	

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **I** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L’attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITA" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**Qualità**" saranno in ogni caso attribuiti **70** punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35** punti, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

Preliminarmente, gli utilizzatori, hanno proceduto alla preventiva verifica circa il possesso da parte delle Ditte concorrenti, delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena esclusione.

Da un'analisi delle proposte acquisite agli atti è emerso quanto segue:

- che la ditta Stryker non è in possesso della caratteristica essenziale al punto A-17 "*Materasso antidecubito ad uso cardiologico*" ed, in particolare, come chiarito mediante FAQ pubblicata sul portale ME.PA – Acquisti in rete in data 08.07.2022, l'attrezzatura offerta non è dotata di materasso antidecubito ad uso cardiologico in schiuma viscoelastica;
- che la ditta Gardhen Balance non è in possesso né della caratteristica essenziale al punto A-8 "*Estensione integrata del piano rete almeno di circa 30 cm*", né di quella al punto A-18 "*Alloggiamenti per aste porta flebo, solleva paziente, sistemi di trazione, ...*"

Si dispone, quindi, l'esclusione dal procedimento di gara delle Ditte Stryker e Gardhen Balance in quanto carenti delle caratteristiche e delle prestazioni essenziali espressamente richieste nel Capitolato Speciale.

Tutto ciò premesso, la Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, sulla base della documentazione tecnica prodotta dai soggetti concorrenti, decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità" in esame:

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	Tip. Criterio	Punteggio	MALVESTIO	HILL-ROM
B-1	Piano rete a pannelli: materiale plastico antibatterico Parametri valutativi indicati negli allegati riferiti ai punti A-4	D	4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 4
B-2	Piano rete a pannelli: sanificazione ed igienizzazione Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-4	D	5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 5
B-3	Telaio in struttura metallica e tipologia della struttura Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-5	T	5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5

B-4	Estensione integrata del piano rete di almeno circa 30 cm Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-5	Q	4	Punteggio = 4	Punteggio = 0
B-5	Testiera e pediera Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-6	Comando manuale CPR lato operatore Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	T	6	Requisito presente Punteggio = 6	Requisito presente Punteggio = 6
B-7	Movimentazione Trendelemburg e anti Trendelemburg (valutazione dell'intervallo in gradi delle inclinazioni) Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	Q	6	Punteggio = 5,65	Punteggio = 6
B-8	Pannello di controllo primario per l'operatore: tasto unico per la posizione di sedia cardiologica, tasto unico per la posizione di visita, blocco di tutte o parti delle funzioni in uso al paziente: numero di servizi e funzioni disponibili sul pannello di controllo Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-9	Q	6	Punteggio = 6	Punteggio = 5,45
B-9	Sistema di alimentazione elettrica a rete e tramite batteria tampone ricaricabile e indicatore dello stato di carica della batteria ed autonomia della stessa Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-16	Q	4	Punteggio = 0,25	Punteggio = 4
B-10	Materasso antidecubito ad uso cardiologico: tipologia e modalità funzionale, facilità di sanificazione ed igienizzazione Parametri valutativi indicati nell'allegato riferito al punto: A-17	D	12	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 12	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1,0 Punteggio = 12
B-11	Durata garanzia di tutto il sistema	T	6	Requisito presente, > di 36 mesi Punteggio = 6	Requisito presente, > di 36 mesi Punteggio = 6
B-12	Organizzazione assistenza	D	6	Giudizio = Eccellente	Giudizio = Eccellente

	tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto, descrizione piano di manutenzione preventiva, disponibilità di attrezzatura sostitutiva in caso di tempi di riparazione prolungati			Coefficiente = 1,0 Punteggio = 6	Coefficiente = 1,0 Punteggio = 6
	TOTALE		70	65,90	65,45
	TOTALE RIPARAMETRATO			70	69,52

RIF. B-4

Ditta Hill-Rom

Estensione del piano rete: 20 cm.

Ditta Malvestio

Estensione del piano rete: 30 cm.

RIF. B-7

Ditta Malvestio

Movimentazione Trendelemburg ed anti Trendelemburg in gradi: +/- 16°

Ditta Hill-Rom

Movimentazione Trendelemburg ed anti Trendelemburg in gradi: +/- 17°

RIF. B-8

Ditta Malvestio

Numero di servizi e funzioni: 11

Ditta Hill-Rom

Numero di servizi e funzioni: 10

RIF. B-9

Ditta Malvestio

Durata batteria: 70-90 minuti. Non avendo indicato un dato certo ed univoco, ai fini del calcolo del punteggio si è scelto il parametro di durata più alto.

Ditta Hill-Rom

Durata batteria: 24 ore

RIF. B-11

Ditta Malvestio

Durata garanzia: 37 mesi

Ditta Hill-Rom

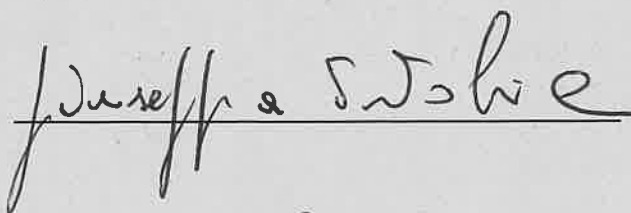
Durata garanzia: 48 mesi

La Commissione Giudicatrice conclude i lavori redigendo il presente verbale che, composto da n. 8 facciate comprese le sottoscrizioni, viene successivamente letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti e trasmesso alla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale per i successivi adempimenti.

Data 26.09.2022

Presidente

Dott. Giuseppe Tortolina

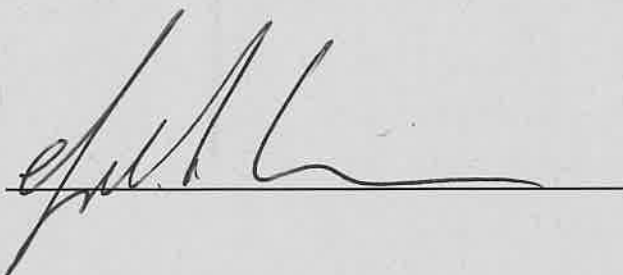
Handwritten signature of Giuseppe Tortolina in black ink, written over a horizontal line.

Componenti

Ing. Andrea Orsi

Handwritten signature of Andrea Orsi in black ink, written over a horizontal line.

Ing. Massimo Giacobbe

Handwritten signature of Massimo Giacobbe in black ink, written over a horizontal line.